OSSENBERG
Qualität fest im Griff

SARS-CoV-2

CE

Antigen Schnelltest

(Kolloidale Gold-Immunochromatographie)

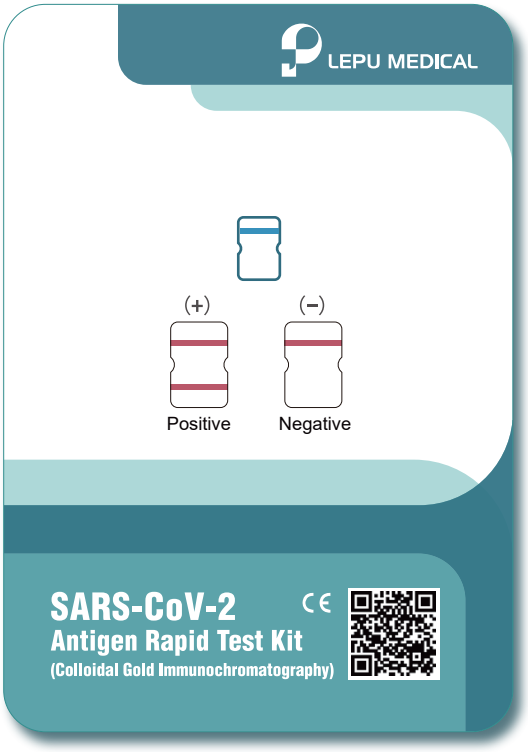

1. Nicht-invasiv
2. Einfach zu bedienen
3. Bequem, keine Geräte erforderlich
4. Schnell, Ergebnis in 15 Minuten
5. Stabil, mit hoher Genauigkeit
6. Kostengünstig, Kosteneffizient

Krankenhaus | Testzentrum | Flughafen | Nah- und Fernverkehr | Hotel | Unternehmen | Massen Untersuchung

Anweisung

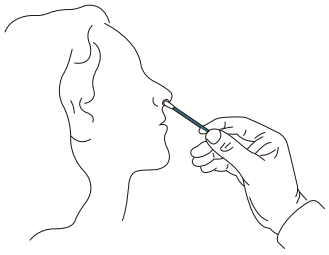

Schritt 1:
Verwenden Sie den Tupfer zur Probenentnahme.

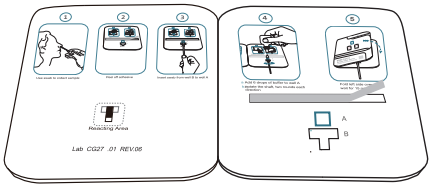

Schritt 2:
Ziehen Sie die Klebefolie ab.

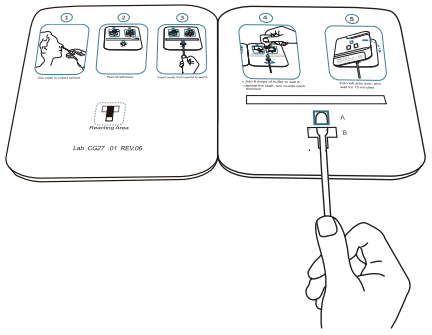

Schritt 3:
Tupfer von Vertiefung B in Vertiefung A fädeln.

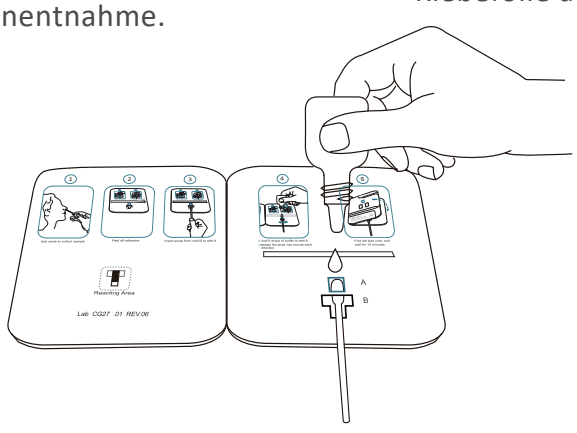

Schritt 4:
a. Geben Sie 6 Tropfen des Verdünnungsmittels in Vertiefung A.
b. Drehen Sie den Tupferkopf, zwei Runden in jede Richtung.

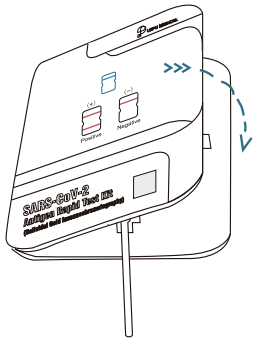

Schritt 5:
Falten Sie die linke Seite um und warten Sie 15 Minuten

Ergebnis-Interpretation

Positiv (+)

Negativ (–)

Ungültig

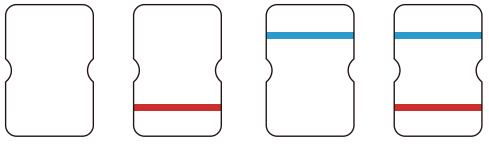

Ossenberg GmbH
Kanalstraße 79
48432 Rheine
Tel: +49 (0) 5971-98046-0
Fax: +49 (0) 5971-98046-16
info@ossenberg.com